

## مقایسه‌ی کلینیکی طول کanal ریشه‌ی دندان‌های مولر شیری فک پایین با استفاده از دستگاه آپکس یاب و پرتونگاری معمولی

طاهره اسکندریان<sup>\*</sup>، صفورا صاحبی<sup>\*\*</sup>، فروغ امیرآبادی<sup>\*\*\*</sup>، عباس علی پور<sup>\*\*\*\*</sup>

<sup>\*</sup> استادیار گروه آموزشی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

<sup>\*\*</sup> استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

<sup>\*\*\*</sup> استادیار گروه آموزشی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

<sup>\*\*\*\*</sup> دستیار تخصصی گروه آموزشی اپیدمیولوژی، دانشکده بیهوداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

### چکیده

**بیان مساله:** برای موفق بودن درمان پالپکتومی در دندان‌های شیری اندازه‌گیری دقیق طول کanal ریشه لازم است. تعیین طول با استفاده از پرتونگاری رایج‌ترین روش مورد استفاده بوده، اما به دلیل عوارض سوء پرتو و همچنین لزوم همکاری کودک معمولاً با مشکلاتی همراه است.

**هدف:** هدف از بررسی کنونی، ارزیابی دقت دستگاه آپکس یاب الکترونیکی Root zx در اندازه‌گیری طول کanal دندان‌های مولر شیری فک پایین و مقایسه‌ی آن با روش پرتونگاری در کودکان ۴ تا ۶ ساله بود.

**مواد و روش:** این بررسی، بر روی ۱۵ دندان مولر (۶ کanal) شیری فک پایین کودکان ۴ تا ۶ ساله با درمان انتخابی پالپکتومی در شرایط بالینی انجام گرفت. طول کanal ریشه‌ی دندان‌ها توسط دستگاه Root zx تعیین و ثبت گردید. پس از ثبت طول کارکرد با گذاشتن دوباره‌ی فایل‌های مربوط به هر کanal با همان طول و رفننس از سطح اکلوزال کلیشه‌ی پرتونگاری با روش موائز فراهم شد. واکاوی داده‌ها توسط آزمون‌های آماری رگرسیون خطی ساده (Simple linear regression)، ضریب همبستگی (Coefficient of correlation) و ضریب تغییرپذیری (Coefficient of variability) و نیز روش آماری گرافیکی بلاند-آلتمن (Bland-Altman plot) انجام گرفت.

**یافته‌ها:** دقت دستگاه آپکس یاب در محدوده‌ی  $5 \pm 0.5$  میلی‌متر از فورامن اپیکال ۸۵ درصد برآورد گردید. در همه‌ی دندان‌ها، بی در نظر گرفتن وضعیت پالپ میان میزان طول کanal ریشه به وسیله‌ی آپکس یاب و پرتونگاری اختلاف آماری معنادار به دست نیامد.

**نتیجه‌گیری:** با توجه به نتایج به دست آمده از این بررسی، استفاده از دستگاه آپکس یاب الکترونیکی برای تعیین طول کanal در دندان‌های مولر شیری فک پایین که تحلیل ریشه ندارد پیشنهاد می‌گردد. به ویژه اگر این اندازه‌گیری همراه با استفاده از پرتونگاری تشخیصی آغازین باشد.

**واژگان کلیدی:** آپکس یاب الکترونیکی، Root zx، پالپکتومی، دندان مولر شیری، پرتونگاری

## درآمد

Root zx یکی از دستگاه‌های آپکس یاب الکترونیکی نسل

سوم است، که به عنوان نمایه‌ای برای مقایسه‌ی دیگر دستگاه‌های آپکس یاب در نظر گرفته می‌شود<sup>(۱)</sup>. استفاده از دستگاه‌های آپکس یاب در تعیین طول کanal دندان‌های دائمی به گونه‌ی معمول انجام می‌شود، اما در دندان‌های شیری برسی‌های ناچیز و بیشتر به صورت آزمایشگاهی (In vitro) وجود دارد، که دقت دستگاه را در تعیین طول کanal های دندان‌های شیری قابل اعتماد می‌داند<sup>(۲)</sup>. پژوهشی برای مقایسه‌ی این دستگاه با پرتونگاری در شرایط بالینی در دندان‌های شیری در دسترس نیست.

بررسی کنونی، با هدف اندازه‌گیری طول کanal های ریشه‌ی مولرهای شیری در فک پایین کودکان توسط این دستگاه و مقایسه‌ی آن با نتایج به دست آمده از انجام پرتونگاری با روش موازی بر روی همان دندان‌ها انجام شده است.

## مواد و روش

گونه‌ی پژوهش مقطعی، روش نمونه‌گیری آسان و شمار نمونه ۶۰ کanal از میان کودکان مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۸۷ تا ۸۸ بود. ۲۵ کودک در رده‌ی سنی ۴ تا ۶ سال که دارای مولرهای شیری فک پایین نیازمند به درمان پالپکتومی بودند، برای انجام برسی در نظر گرفته شدند. از این شمار ۱۲ نفر به دلیل همکاری نکردن در هنگام درمان یا تهیه‌ی پرتونگاری از بررسی کنار گذاشته شدند. سرانجام دندان‌های مورد پژوهش، شامل ۱۵ دندان (۵ دندان نکروز و ۱۰ دندان غیرنکروز) برسی گردیدند.

روش انتخاب دندان‌ها با در نظر گرفتن شرایط پرتونگاری و بالینی همچون تورم، قرمزی و التهاب بافت لتهی مجاور دندان و استفاده از آزمون حفره (Cavity test) با نتایج نکروز یا التهاب شدید و پرخونی پالپ انجام شد. در صورت مشاهده مواردی همچون اکسپوز فورکا، تخریب گستردگی تاج به گونه‌ای که دندان قابل ترمیم نباشد، تحلیل‌های پاتولوژیک درونی و بیرونی آشکار و همچنین تحلیل فیزیولوژیک ریشه، کلسیفیکاسیون‌های درون کanal، دندان مورد نظر از برسی کنار گذاشته می‌شد. رضایت نامه برای شرکت در انجام طرح از پدر و مادر یا همراه بیمار گرفته شد.

پس از انتخاب دندان و تهیه‌ی پرتونگاری، تزریق بی‌حسی

یکی از اهداف مهم در دندانپزشکی کودکان حفظ و نگهداری دندان‌های شیری تا زمان رویش دندان‌های دائمی جانشین شونده است<sup>(۱)</sup>. زود از دست دادن دندان‌های شیری به مشکلاتی همچون ناهنجاری در اکلوژن و کاهش توانایی در جویدن می‌انجامد<sup>(۲)</sup>. پالپکتومی از روش‌های درمانی مناسب جهت حفظ دندان‌های شیری با درگیری پالپ است. در خود به خود، پرخونی پالپ و وجود برخی نشانه‌ها در پرتونگاری (همچون درگیری ناحیه‌ی فورکیشن ریشه‌ها) همه از مواردی است که انتخاب درمان پالپکتومی برای دندان‌های شیری را مطرح می‌نمایند<sup>(۳)</sup>.

برای موفقیت آمیز بودن درمان ریشه در دندان‌های شیری، طول کanal ریشه باید به گونه‌ی دقیق اندازه‌گیری گردد، تا از وارد آمدن آسیب به جوانه‌ی دندانی جانشین شونده جلوگیری نماید<sup>(۴)</sup>. برای تعیین طول کارکرد ریشه شناخت کالبدی آپکس لازم است. مطلوب‌ترین جا برای تعیین طول کارکرد ریشه تنگه‌ی اپیکالی یا کوچکترین قطر اپیکالی بوده، که از بافت پالپ به بافت اپیکال تغییر ماهیت داده و اتصال سمت‌توم به دنتین (CDJ) نامیده می‌شود<sup>(۵)</sup>.


معمولًاً تعیین جای واقعی تنگه‌ی اپیکالی در دندان‌های شیری که فرسودگی فیزیولوژیک را آغاز نموده یا دچار روند تحلیل پاتولوژیک ریشه (به دلایل عفونت، ضربه‌ی دندانی یا نیروهای بیشتر از اندازه ارتدنسی) شده‌اند با مشکلاتی رو به روست<sup>(۶)</sup>. از سویی، چون شکل و موقعیت آپکس ریشه در دندان‌های شیری با گذشت زمان به گونه‌ی پیاپی در حال تغییر است بنابراین، تعیین

جای دقیق فورامن اپیکال به سختی امکان پذیر می‌گردد<sup>(۴)</sup>.

رایج‌ترین روش تعیین طول کanal ریشه در درمان‌های اندودنتیک استفاده از پرتونگاری بوده، ولی در کودکان به دلیل ضررهای پرتو، احتمال همکاری نکردن کودک و روی هم افتادن تصویر جوانه‌ی دندان‌های دائمی و ریشه‌ی دندان‌های شیری این امر با مشکلاتی همراه است<sup>(۷)</sup>. استفاده از روشی که این خطرات و مشکلات را در پی نداشته باشد همواره در نظر بوده، که در همین راستا استفاده از دستگاه‌های آپکس یاب الکترونیکی برای تعیین طول کanal ریشه دندان شیری مطرح می‌شود. مهم‌ترین برتری این دستگاه‌ها بر پرتونگاری این است، که می‌تواند طول ریشه را تا انتهای واقعی فورامن اپیکال اندازه‌گیری کند<sup>(۷)</sup>.

وسیله‌ی اپکس یاب و پرتونگاری در همه‌ی دندان‌ها، دندان‌های نکروز و غیرنکروز به ترتیب  $1/0.5 \pm 0.05$  و  $1/0.6 \pm 0.06$  میلی‌متر به دست آمد. سپس آشکار گردید، که در ۳۷ کanal ( $61/7$  درصد) میان اندازه‌های دو روش هیچ تفاوتی وجود نداشته است. همچنین، با در نظر گرفتن محدوده‌ی  $0.5$  میلی‌متر تفاوت میان اندازه‌های دو روش به عنوان نقطه‌ی مرزی (*Cut off point*)،  $14$  کanal ( $23/4$  درصد) در این محدوده قرار گرفت و تنها در  $9$  کanal ( $15$  درصد) اختلاف میان دو اندازه بیشتر از این محدوده بود (همانگی  $85$  درصد میان اندازه‌های دو روش).

ضریب همبستگی میان اندازه‌ی طول کanal ریشه به وسیله‌ی اپکس یاب و پرتونگاری در همه‌ی دندان‌ها  $0.864$  ( $p = 0.0001$ )، در دندان‌های نکروز  $0.827$  ( $p = 0.0001$ ) و در دندان‌های غیر نکروز  $0.898$  ( $p = 0.0001$ ) گزارش شد.

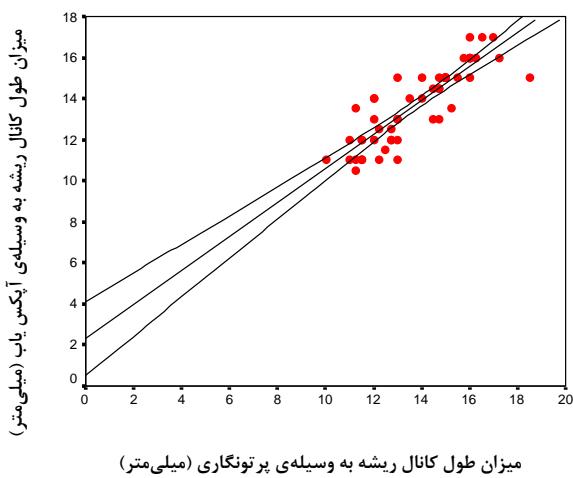

ضریب همبستگی اندازه‌های طول کanal به دست آمده در پرتونگاری توسط دو درمانگر  $0.874$  ( $p = 0.0001$ ) بود.

ضریب تعییرپذیری، برای میزان طول کanal ریشه به وسیله‌ی اپکس یاب و پرتونگاری برای همه‌ی دندان‌ها  $3/3$  درصد، دندان‌های نکروز  $4$  درصد و دندان‌های غیر نکروز  $3/1$  درصد ارزیابی گردید، که نشان دهنده‌ی میزان هماهنگی بالای دو روش بالاست.

از الگوی رگرسیون خطی، برای ارزیابی روایی میان طول کanal ریشه به وسیله‌ی اپکس یاب و پرتونگاری در دندان‌های

با گزیلوکائین (دارو پخشش - ایران) و با روش بلاک مندیبولا ر انجام گرفت. پس از برداشتن همه‌ی پوسیدگی‌ها تا نزدیکی سقف اتاقک پالپ، با قرار دادن رابردم دندان مورد نظر ایزوله گردید. سپس، حفره‌ی دسترسی توسط فرز گرد استریل توربین (مانی - ژاپن) فراهم شد. هنگام تهیه‌ی حفره‌ی دسترسی، نکروز و یا زنده بودن کanal‌ها با مشاهده‌ی مستقیم آشکار و ثبت گردید. در موارد خونریزی شدید پالپ، بافت ملتهب نواحی بالای کanal با بروج مناسب (مانی - ژاپن) بیرون آورده شد، تا به این ترتیب خونریزی مهار شده و در اندازه‌گیری طول با دستگاه اپکس یاب ناهنجاری ایجاد نشود.

دستگاه اپکس یاب مورد استفاده در این بررسی، Rootzx (جی سی موریتا - ژاپن) بود. برای اندازه‌گیری طول کanal‌ها در این پژوهش، بر پایه‌ی دستور کارخانه‌ی سازنده عمل گردید. گیره‌ی لبی دستگاه در گوشه‌ی لب و فایل نگهدار به فایل شماره‌ی  $15$  یا  $20$  (مانی - ژاپن) متصل شد. فایل به آرامی در درون کanal حرکت داده می‌شد، تا جایی که دستگاه حرکت فایل را به سمت اپکس و قرار گرفتن نوک فایل را در ناحیه‌ی فورامن اپیکال (صفر میلی‌متر) نشان دهد. سپس، فایل را حدود نیم میلی‌متر عقب کشیده تا دستگاه نوک فایل را در  $0.5$  میلی‌متر اپکس نشان دهد. رابر استاپ فایل را روی نقطه‌ی مشخصی از سطح اکلوزال که برای هر یک از دندان‌ها ثبت می‌گردید قرار داده و پس از قطع اتصال فایل نگهدار و بیرون آوردن فایل فاصله‌ی نوک آن تا رابر استاپ با استفاده از خط کش اندومتر اندازه‌گیری و ثبت گردید.

همه‌ی مراحل بالا برای هر یک از کanal‌های دندان به گونه‌ی جداگانه و توسط یک عمل کننده انجام شد. پس از ثبت طول کارکرد توسط دستگاه Rootzx با گذاشتن دوباره‌ی فایل‌های مربوط به هر کanal با همان طول مشخص شده توسط دستگاه و رفرنس سطح اکلوزال، کلیشه‌ی پرتونگاری با روش موازی فراهم شد و پس از مراحل ظهور و ثبوت مناسب، همه‌ی کلیشه‌ها توسط دو نفر جهت تعیین طول خوانده و نتایج جداگانه ثبت گردید. واکاوی داده‌ها توسط آزمون‌های آماری رگرسیون خطی ساده، ضریب همبستگی و ضریب تعییرپذیری و نیز، روش آماری گرافیکی بلاند - آلتمن (Bland-Altman plot) انجام گرفت.


## یافته‌ها

میانگین و انحراف معیار اختلاف میان طول کanal ریشه به

طول کanal ریشه هم در دندان‌های دائمی و هم شیری استفاده شده است. یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های آپکس یاب که به عنوان نمایه‌ای در مقایسه‌ی دیگر دستگاه‌های آپکس یاب بوده، دستگاه Root zx (J.Morita, Tokyo, Japan) است<sup>(۸)</sup>. در زمینه‌ی دقت این دستگاه بررسی‌های فراوانی بر روی دندان‌های دائمی انجام گرفته، اما بررسی‌های محدودی در تعیین طول کanal ریشه‌ی دندان‌های شیری به صورت آزمایشگاهی و بالینی وجود دارد. در بررسی‌های آزمایشگاهی از ژلی به عنوان هادی جریان که نقش بافت‌های پیرامون دندان در دهان را بازی می‌کند، استفاده می‌شود. از آن جا که این ژل نمی‌تواند به گونه‌ی کامل همانند بافت‌های پیرامون دندان در برابر جریان‌های الکتریکی عمل کند و نیز نمی‌تواند به گونه‌ی کامل رابطه‌ای همانند رابطه‌ی بافت‌های پیرامون دهان با کanal دندان در دهان داشته باشد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که نتایج به دست آمده از بررسی‌های آزمایشگاهی و بالینی یکسان باشند<sup>(۹)</sup>. بیشتر بررسی‌های موجود در این زمینه به صورت آزمایشگاهی است، که در رابطه با دندان‌های شیری می‌توان به بررسی کاتز (Katz)، منته (Mente)، شهرابی، لوناردو (Leonardo)، توسعون (Tosun) و انگوارونگ (Angwaravong) اشاره نمود. در بررسی‌های بالینی انجام گرفته نیز، پس از اندازه‌گیری طول کanal ریشه توسط دستگاه، دندان مورد نظر کشیده شده و طول واقعی دندان اندازه‌گیری شده است. بررسی کیلباسا (Kielbassa)، شهرابی، قائم مقامی از جمله این بررسی‌هاست.

در بررسی کنونی، طول اندازه گرفته شده توسط آپکس یاب با پرتونگاری در شرایط بالینی ارزیابی گردید. علت انتخاب روش و نیز دقت بالای روش پرتونگاری موازی در تعیین طول کanal ریشه‌ی دندان‌هاست<sup>(۱۰)</sup>. دلیل انتخاب دندان‌های مولر شیری فک پایین همسان سازی متغیرهای احتمالی در مراحل

نکروز، غیر نکروز و در همه‌ی دندان‌ها استفاده گردید (جدول ۱). همان‌گونه که در جدول ۱ و نمودار ۱ نشان داده شده است، مقایسه‌ی میان این خطوط با خط رگرسیون دارای ضریب رگرسیون (شیب) مساوی با یک و عرض از مبدأ مساوی با صفر (یعنی خطی که از مبدأ مختصات با زاویه‌ی ۴۵ درجه و از نواحی ۱ و ۳ مثلثاتی می‌گذرد و بیانگر هماهنگی کامل میان دو سری از اندازه‌گیری‌هاست) اختلاف معنادار آماری را نشان نداد ( $p < 0.05$ ). نمودار گرافیکی بلاند - آلتمن (Bland-Altman plot) نشان داد، که در همه‌ی کanal‌ها و گروه‌های نکروز و غیر نکروز، دو روش تشخیصی بالا در حقیقت یک معیار را اندازه‌گیری نموده و به بیان دیگر بیانگر هماهنگی بالای دو روش اندازه‌گیری است (نمودار ۲).

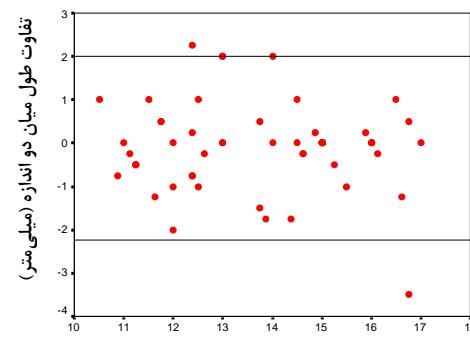

نمودار ۲ نمودار Bland-Altman برای بررسی هماهنگی میان مقادیر اندازه‌گیری شده، میزان طول کanal ریشه به وسیله‌ی آپکس یاب و پرتونگاری در همه‌ی دندان‌ها (هر نمایه نشان دهنده چندین شرایط یکسان است)

## بحث

تعیین طول کanal عاملی مهم در درمان موفق ریشه<sup>(۱۱)</sup>، به ویژه در دندان‌های شیری به دلیل وجود جوانه‌ی دندان دائمی زیرین این مساله دارای اهمیت ویژه‌ای است<sup>(۱۰)</sup>. روش مرسوم برای اندازه‌گیری طول کanal ریشه پرتونگاری بوده که دارای معایب و محاسبی است. از آپکس یاب‌های الکترونیکی برای تعیین

**جدول ۱** پیوند میان میزان طول کanal ریشه به وسیله‌ی آپکس (متغیر غیر وابسته) با روش‌های رگرسیون ساده

	ضریب ثابت (عرض از مبدأ)						وضعیت پالپ	متغیرهای غیر وابسته
	ضریب رگرسیون (شیب)	ضریب	خطای معيار	p value <sup>1</sup>	ضریب	خطای معيار		
	p Value <sup>2</sup>							
میزان طول کanal ریشه به وسیله‌ی پرتونگاری	۰/۰۷	۰/۰۷	۰/۸۸۷	۰/۱۰۱	۰/۹۷۸	۱/۶۴۳	نکروز	
	۰/۸	۰/۱۶۶	۱/۰۰۶	۰/۸۸۵	۲/۲۸	۰/۱۳۶	غیر نکروز	
	۰/۲	۰/۰۷	۰/۹۰۴	۰/۱۴۹	۰/۹۶۹	۱/۴۱۶	همه دندان‌ها	

۱. مقایسه با عرض از مبدأ مساوی صفر

۲. مقایسه با شیب مساوی ۱

مساوی بوده و در ۱۶ درصد موارد طول اندازه‌گیری شده توسط  $\text{Root zx} \pm 0/5$  میلی‌متر کوتاه‌تر و در ۱۴ درصد موارد  $0/5 \pm 0/0$  میلی‌متر بلندتر از طول اندازه‌گیری شده توسط مشاهده‌ی مستقیم بوده است. در بررسی کنونی ۶۱/۷ درصد کanal‌های اندازه‌گیری شده توسط  $\text{Root zx}$  با طول اندازه‌گیری شده توسط پرتونگاری مساوی بوده و در ۲۳/۳ درصد طول اندازه‌گیری شده توسط  $0/0 \pm 0/5$  میلی‌متر کوتاه‌تر یا بلندتر از طول اندازه‌گیری شده توسط پرتونگاری است. تفاوت‌های میان این دو بررسی را می‌توان به دلیل گونه‌ی متفاوت دندان‌ها و نیز شرایط مقایسه‌ی دستگاه مشاهده‌ی مستقیم در برابر پرتونگاری) یاد نمود. در بررسی کنونی، دقت اپکس یا ب در همه‌ی دندان‌ها چه نکروز و چه غیر نکروز همانند دیگر بررسی‌های انجام شده پیشین از دقت بالایی برخوردار بود.

### نتیجه‌گیری

استفاده از دستگاه اپکس یا ب الکترونیکی  $\text{Root zx}$  برای تعیین طول کanal ریشه در دندان‌های بی فرسودگی مولر شیری فک پایین (بی توجه به وضعیت پالپ) پیشنهاد می‌شود و در صورتی که همراه با پرتونگاری تشخیص آغازین استفاده گردد نتیجه‌ی پذیرفتنی تری به دست می‌آید. برای استفاده از این دستگاه در دیگر دندان‌های شیری و همچنین دندان‌های دچار فرسودگی ریشه نیاز به بررسی‌های بالینی بیشتری است.

### قابل توجه

این مقاله از پایان‌نامه‌ی دوره‌ی دکترای تخصصی، که به راهنمایی دکتر طاهره اسکندریان و مشاوره دکتر صفورا صاحبی و نگارش دکتر فروغ امیر آبادی به شماره‌ی ۱۲۲۱ در کتابخانه‌ی دانشکده‌ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ثبت شده، استخراج گردیده است.

درمان و انجام پرتونگاری موازی بوده است. از آن جا که معمولاً یک سال پس از پایان رویش دندان شیری، اپکس بسته می‌شود و فرسودگی فیزیولوژیک به دنبال این امر انجام می‌گردد<sup>(۹)</sup>، بنابراین محدوده‌ی سنی ۴ تا ۶ سال به دلیل میزان کم فرسودگی فیزیولوژیک ریشه انتخاب گردید.

در این بررسی، دقت دستگاه  $\text{Root zx}$  در محدوده‌ی  $0/5 \pm 0/0$  میلی‌متری از فورامن آپیکال ۸۵ درصد به دست آمد (جدول ۱). کاتز و همکاران، دقت دستگاه  $\text{Root zx}$  در تعیین طول کanal دندان‌های شیری را در ۲۰ کanal به گونه‌ی آزمایشگاهی در محدوده‌ی  $0/5 \pm 0/0$  میلی‌متر از فورامن آپیکال ۱۰۰ درصد به دست آوردند.

بررسی کیلیاسا و همکاران، بر روی دندان‌های شیری با استفاده از  $\text{Root zx}$  نشان داد، که هر چند دستگاه تمایل ناچیزی به کوتاه‌تر نشان دادن طول کanal ریشه دارد ولی، روی هم رفته از دقت کافی ( $64 \pm 1$  درصد در محدوده‌ی  $1 \pm 0/5$  میلی‌متری از فورامن آپیکال) در تعیین طول کanal ریشه برخوردار است. در این بررسی، دقت  $\text{Root zx}$  تحت اثر گونه‌ی دندان، کanal ریشه، وضعیت پری اپکس و شرایط بالینی دندان قرار نگرفته بود. در بررسی شهرابی و همکاران، دقت دستگاه  $\text{Dentaport zx}$  در فاصله‌ی  $0/5 \pm 0/0$  میلی‌متر از فورامن آپیکال،  $92/17$  درصد به دست آمد.

دلیل تفاوت نتایج بررسی کنونی، نسبت به بررسی‌های باد شده را می‌توان به شرایط متفاوت این بررسی همچون انجام بررسی در شرایط بالینی، نیاز بیشتر به همکاری کودک در مراحل گوناگون درمان، یکسان نبودن گونه‌ی دندان‌های مورد بررسی و لزوم نبود فرسودگی در بررسی کنونی در پیوند دانست.

قایم مقامی و همکاران، دقت  $\text{Root zx}$  را در شرایط بالینی بر روی ۱۵ دندان ثایای شیری بررسی کردند. نتایج آن‌ها نشان داد، که در ۶۵ درصد کanal‌ها طول اندازه‌گیری شده توسط  $\text{Root zx}$  با طول اندازه‌گیری شده توسط مشاهده‌ی مستقیم

## References

1. Angwaravong O, Panitvisai P. Accuracy of an electronic apex locator in primary teeth with root resorption. *Int Endod J* 2009; 42: 115-121.
2. Bodur H, Odabaş M, Tulunoğlu O, Tinaz AC. Accuracy of two different apex locators in primary teeth with and without root resorption. *Clin Oral Investig* 2008; 12: 137-141.
3. Pinkham JR, Casamassim OPS, Metcigue DJ, Fields HW, Nowak AJ. Pediatric dentistry infancy through Adoloscence. 4 th ed. Saunders Elsevier; 2005. P. 380-387.
4. Kielbassa AM, Muller U, Munz I, Monting JS. Clinical evaluation of the measuring accuracy of ROOT ZX in primary teeth. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2003; 95: 94-100.
5. Kim E, Lee SJ. Electronic apex locator. *Dent Clin North Am* 2004; 48: 35-54.
6. Shahrabi M, Seraj B, Heidari A. In vivo evaluation of the accuracy of an electronic apex locator in root canal length determination in primary teeth. *J Dent Med* 2006; 19: 79-83.
7. Griffiths BM, Brown JE, Hyatt AT, Linney AD. Comparison of three imaging techniques for assessing endodontic working length. *Int Endod J* 1992; 25: 279-287.
8. Gordon MP, Chandler NP. Electronic apex locators. *Int Endod J* 2004; 37: 425-437.
9. Cohen S, Burns RC. Pathways of the pulp. 8 th ed., St. Louis: Mosby; 2002. p.799.
10. Nekoofar MH, Ghandi MM, Hayes SJ, Dummer PM. The fundamental operating principles of electronic root canal length measurement devices. *Int Endod J* 2006; 39: 595-609.
11. Dandashi MB, Nazif MM, Zullo T, Elliott MA, Schneider LG, Czonstkowski M. An in vitro comparison of three endodontic techniques for primary incisors. *Pediatr Dent* 1993; 15: 254-256.
12. Torabinejad M, Walton RE. Endodontics principles and practice. 4th ed., Saunders Elsevier: St.Louis; 2009. p.188.